# Trasduttori clinici




**Standard Fetale 2 MHz**
**REF BT2M20S8C**



**Fotopletismografia solo PPG**
**REF PG-21**



**Standard 4, 5, 8, 10 MHz**
**REF ST*M05S8C**



**Fotopletismografia solo PPG compatibile solo con BIDOP 7 REF PG-30**




**Standard**
**4MHz REF BT4M05S8C**
**5MHz REF BT5M05S8C**
**8MHz REF BT8M05S8C**
**10 MHz REF BT10M5S8C**




**Sandard Fetale**
**REF ST2M25S8C**



**Matita 8 MHz**
**REF BP8M05S8A**




**Piatto per monitorizzazione 8 MHz**
**REF BF8M15S8A**

* Inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto


Hadeco®

| Modello REF | Utilizzo | Tipo | Frequenza | Metodo sterilizzazione | Richiesto amplificatore | ES-100V3 | ES-100VX | Smartdop SD-45 | BIDOP7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT4M05S8C** | Clinico | Standard | 4 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **BT5M05S8C** | Clinico | Standard | 5 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **BT8M05S8C** | Clinico | Standard | 8 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **BT10M5S8C** | Clinico | Standard | 10 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **BP8M05S8A** | Clinico | Matita | 8 | N /A | - | - | ● | - | - |
| **BF8M15S8A** | Vascolare/Monitoriz. | Piatto | 8 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **PG-21** | PPG/pletismografia | | | | - | ● | - | ● | - |
| **BT2M20S8C** | Fetale | Standard | 2 | N /A | - | ● | ● | ● | - |
| **SF8M15S8A** | Vascolare/Monitoriz. | Piatto | 8 | N /A | - | - | - | - | ● |
| **PG-30** | PPG/pletismografia | | | | - | - | - | - | ● |
| **ST*M05S8C** | Clinico | Standard | 4, 5, 8, 10 | N /A | - | - | - | - | ● |
| **ST2M25S8C** | Fetale | Standard | 2 | N /A | - | - | - | - | ● |

* Inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto

| STERILIZZAZIONE | **EOG (Gas ossido di etilene)** | **Sterrad, J&J (Gas Plasma perossido di idrogeno)** | **Autoclave (5 volte)** |
|---|---|---|---|
| Sonde applicabili | Tutte le sonde sterilizzabili | Tutte le sonde sterilizzabili | |
| Temperatura di sterilizzazione | Sotto i 55 ° C | Sotto i 45 °C | Sotto i 115° C (Sotto i 121°C) |
| Durata della sterilizzazione | 2 - 5 ore con gas 12- 24 ore con aereazione | 45 - 105 min | 30 min (20 min) |

# Scelta del trasduttore

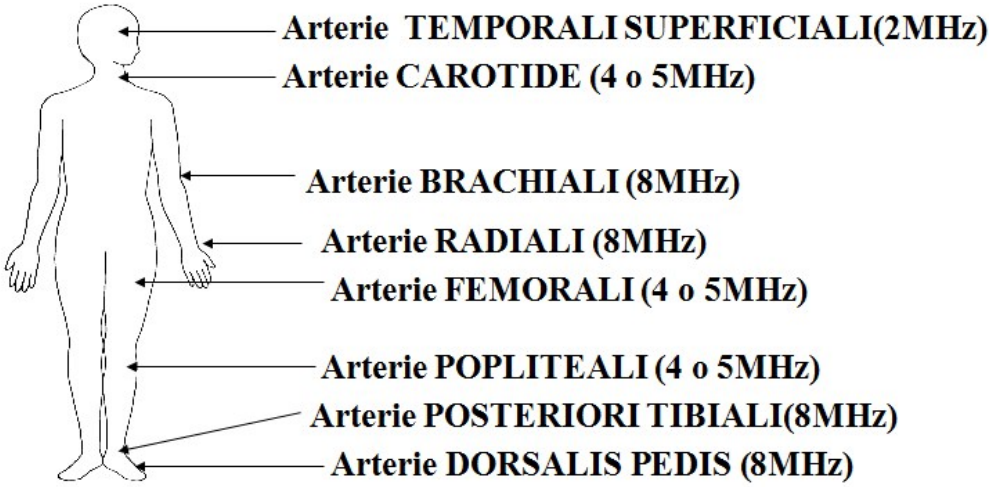


| **FREQUENZA SONDA** | **PROFONDITÀ FOCALE** | **APPLICAZIONI** |
|---|---|---|
| **2 MHz** | **100 mm** | **Fetale** |
| **4 MHz** | **20 mm** | **Vasi profondi o medi (Carotide, Arteria femorale ecc.)** |
| **5 MHz** | **15 mm** | **Vasi profondi o medi (Carotide, Arteria femorale, ecc)** |
| **8 MHz** | **10 mm** | **Vasi periferici (Radiale, arteria PT & DP)** |
| **10 MHz** | **5 mm** | **Dita, Vasi superficiali** |
| **20 MHz** | **3 mm** | **Vasi superficiali** |